


Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<i>Caratteristiche migliorative dell'apparecchiatura</i>	50,5	1.1	Verranno valutate positivamente il peso e le dimensioni ridotte.	3		
			1.2	Verranno valutate positivamente la trasportabilità e manovrabilità.	4		
			1.3	Verrà valutata positivamente la facilità d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione.	2		
			1.4	Verrà valutata positivamente la possibilità di utilizzo con altri radiofarmaci diversi dal F18.	6		
			1.5	Verrà valutata positivamente la minor esposizione dell'operatore durante tutte le fasi di utilizzo dell'apparecchiatura. Ai fini della valutazione sarà necessario specificare il valore di esposizione a 5-10-30 cm di distanza dall'apparecchiatura nelle seguenti fasi: caricamento vial, frazionamento e iniezione del radiofarmaco (F18).	6		
			1.6	Verrà valutato positivamente il minor intervento dell'operatore nelle operazioni di trasferimento/caricamento del contenitore schermato contenente il vial all'interno del frazionatore/iniettore.	6		
			1.7	Presenza di allarmi durante il ciclo lavorativo dell'apparecchiatura.			1
			1.8	Verrà valutata positivamente la manovrabilità, l'ergonomia e facilità d'uso nella fase di somministrazione.	6		
			1.9	Possibilità di iniezione manuale della dose.			2

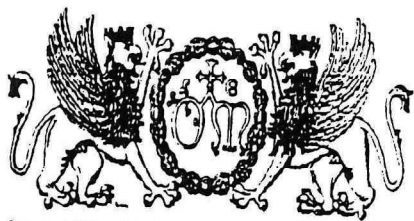


Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

			1.10	Migliore autonomia di funzionamento e movimentazione tramite batteria interna. Verrà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà l'autonomia maggiore, purché superiore a quella minima richiesta nel CT (1 h). Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto. Se il parametro offerto sarà pari a quello richiesto dal capitolato come caratteristica minima, il punteggio assegnato sarà zero.		3,5	
			1.11	Verrà valutata positivamente la possibilità di selezionare diverse velocità di infusione, considerando anche modalità di regolazione e velocità massima.	4		
			1.12	Verranno valutate positivamente le soluzioni adottate per minimizzare lo spreco del radiofarmaco durante le fasi iniziali di carico.	4		
			1.13	Verrà valutata positivamente la possibilità di interruzione dell'iniezione della dose in caso di "fuori vena", considerando anche la presenza di opportuni allarmi.	3		
2	Caratteristiche migliorative del software e interfaccia utente	14	2.1	Integrazione e funzionamento con il gestionale ASTRIM in uso presso la Struttura Complessa Medicina Nucleare.	3		
			2.2	Presenza di interfaccia touch screen per la gestione delle funzionalità dell'apparecchiatura (es. dispensazione del radiofarmaco, etc.).			1
			2.3	Verrà valutata positivamente la possibilità di effettuare la preparazione a freddo della strumentazione.	2		
			2.4	Verrà valutata positivamente intuitività e semplicità di utilizzo dell'interfaccia utente di gestione, compresa anche l'organizzazione e la completezza delle diverse funzionalità selezionabili.	4		

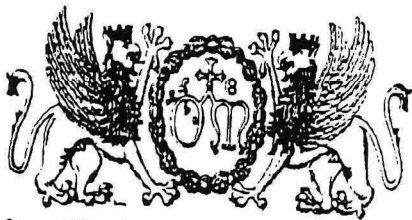


Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

			2.5	Verrà valutata positivamente la possibilità di personalizzare le dosi somministrate (es. timing di iniezione, numero pazienti seduta giornaliera, etc.).	4		
3	Caratteristiche migliorative del materiale di consumo	4	3.1	Verranno valutati positivamente la facilità di montaggio e di utilizzo dei kit, considerando anche la qualità dei materiali.	4		
4	Caratteristiche migliorative dell'assistenza tecnica e formazione del personale	11,5	4.1	Migliori tempistiche di intervento a partire dal momento della chiamata. Sarà premiata l'offerta che garantisce la maggiore riduzione dei tempi di intervento rispetto a quelli indicati nel CT (8 h). Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto. Se il parametro offerto sarà pari a quello massimo richiesto dal Capitolato come caratteristica minima, il punteggio assegnato sarà zero.		3,5	
			4.2	Migliori tempistiche di risoluzione guasto a partire dall'accertamento dello stesso. Sarà premiata l'offerta che garantisce la maggiore riduzione dei tempi di risoluzione guasto rispetto a quelli indicati nel CT (96 h). Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore del parametro offerto. Se il parametro offerto sarà pari a quello massimo richiesto dal Capitolato come caratteristica minima, il punteggio assegnato sarà zero.		3,5	
			4.3	Programma di formazione finalizzato all'uso corretto ed appropriato dei prodotti aggiudicati.	3,5		

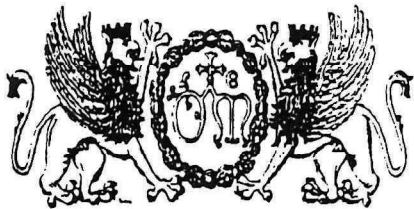

Stemmi dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Menghini, 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S. Andrea delle Fratte – 06129 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531 PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

			4.4	Fornitura di un muletto (equivalente all'apparecchiatura fornita) da utilizzare in caso di fermo macchina superiore ai tempi massimi di risoluzione del guasto (indicare tempi di fornitura del muletto).			1
	TOTALE	80			64,5	10,5	5

Gruppo di progettazione	
SC Farmacia Ospedaliera	
SC Bioingegneria e Ingegneria Clinica	
SC Fisica Sanitaria	
SC Medicina Nucleare	